Broadley-James® Corporation
19 Thomas • Irvine, CA 92618
Tel: (949) 829-5555 • Fax: (949) 829-5560

Title:

Model D400-B070-PT-D9
25 mm OxyProbe®
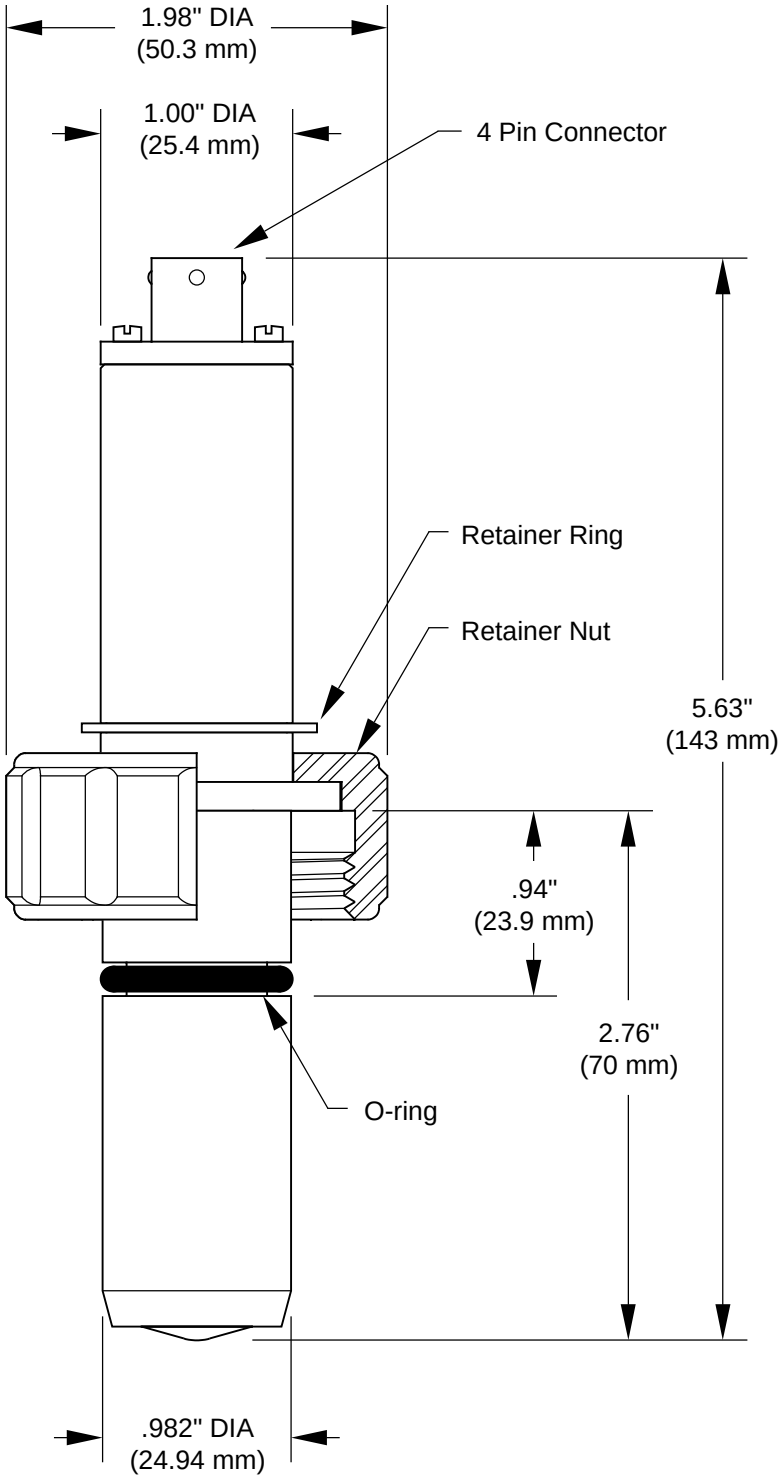
Doc No:	Rev:
P2801	--
Pg: 1 / 1	Date: 09-Oct-09